

SME-REN INKESTA SENDAGILEEI GRAFENODUN MOSUKOEI BURUZ



METODOLOGIA

ABIAPUNTUA

Datak: 2021eko apirilaren 15etik 18ra.

Hedapena: 116 sendagile (106 erantzun gaztelaniaz eman dira eta 10 euskaraz), xede-populazioaren %10 inguru (6.000 - 7.000 sendagile goitik behetik).

Errorea: +/- %1,9 errore-marjina.

Metodologia:

1. Inkesta sortu Google Forms-en.
2. Inkestaren url-a sortu bi hizkuntzetan:
 - Euskara: <https://forms.gle/cNaWBaoLE1EVudqx9>
 - Gaztelania: <https://forms.gle/uKh2Cfwaxajg6cJc7>
3. Inkesta bidali bi bide erabiliz:
 - WhatsApp taldeak.
 - Webgunea (www.sme.es).

Sección 1 de 4

Encuesta del SME sobre la retirada de mascarillas FFP2 con grafeno

A raíz de la retirada de las mascarillas FFP2 Healifer de grafeno fabricadas por Shandong Shengqian New Materials Co., LTD, cuyo proveedor es firm S.A., en el Sindicato Médico de Euzkadi (SME) queremos conocer el USO que se ha dado a este elemento de trabajo tan importante.

Osakidetza nos ha informado hoy, 15 de abril, de que las mascarillas puestas en entredicho tienen 5 capas y es la más interna, la que está en contacto con la boca y la nariz, la que tiene grafeno en su composición. Sin embargo, desde Osakidetza nos aseguran que ESTE MODELO NO SE HA UTILIZADO, aunque sí se han encontrado OTROS que en su composición TIENEN GRAFENO EN LA CAPA INTERMEDIA, sin contacto con la boca y nariz. Así así, han ordenado retirar todas.

Desde el SME, hemos preguntado en QUIÉ SERVICIOS u OÍAS se han utilizado, pero no nos han proporcionado esa información. Por eso, ayudanos a obtener información de primera mano. Por favor, CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS. Pasarán solo te llevará 1 minuto.

Muchas gracias por tu contribución.

Mascarillas FFP2 Healifer de grafeno retiradas

¿Cuál es tu centro de trabajo? *

Texto de respuesta larga

¿Has utilizado esta mascarilla en el trabajo? *

Sí

No

Después de la sección 1 ir a la siguiente sección

Sección 2 de 4

En caso afirmativo:

Descripción (opcional)

¿Durante cuánto tiempo estimas que la has utilizado?

Menos de 1 mes

Entre 1 y 4 meses

Entre 5 y 8 meses

Entre 9 y 12 meses

Más de 1 año

Después de la sección 2 ir a la sección 4 (Sustitución de mascarillas)

Sección 3 de 4

En caso negativo:

Descripción (opcional)

¿En tu centro de trabajo han utilizado este tipo de mascarillas? *

Sí

No

Después de la sección 3 ir a la sección 3 (En caso negativo)

Sección 4 de 4

Sustitución de mascarillas

Descripción (opcional)

¿En tu centro de trabajo han cambiado ya estas mascarillas por otro modelo? *

Sí

No

GALDETEGIAK

Sección 1 de 4

Grafenodun FFP2 maskarak kentzeari buruzko SMERen inkesta

Shandong Shengqian New Materials Co., LTD enpresak fabrikatutako grafenodun FFP2 Healifer maskarak (horri S.A. de homitzaile) Euzkadiko Sindikatoren Sindikatuaok konen garrantzitsua den lan-tresan emari zain ERABILERA eragutu nahi dugu.

Osakidetza (guzt. apirilak 15, jakinarazi digu) apaldu maskaren 5 geruzak dituzela eta barnekoena dela, alioa eta erabilera artetik erabiltzeko grafenoa duena. Hala ere, Osakidetzaok zaurtu du EREKOHOR EZ DELA ERABILI, nahiz eta erabili diren BESTE BATZUEN osarari bai arkitu, oia GRAFENO DUTENAK TARTETEO GUTURIAN, alioa eta erabilera artetik erabiltzeko. Erabili erabiltzeko, erabili erabiltzeko agindua eman dute.

SMEin galdetu digu: er 23081721 eta 0308 erabili diren, baina ez digute informazio hori emari. Inkesta galdetuzko informazioa lantze estutik lortzen laguntzeko. Mesedez, ERANTZUN GALLERIA HAUEI minutu bat besterik ez duzu behar.

Mila esker zure laguntzagatik.

Kendu diren grafenodun FFP2 Healifer maskarak

Zein da zure lantokia? *

Texto de respuesta larga

¿Has utilizado esta mascarilla en el trabajo? *

Bai

Ez

Después de la sección 1 ir a la siguiente sección

Sección 2 de 4

Eranzuna baiezkoa izan bada

Azajepena (aukeraketa)

Zerbat denbora erabili duzue? *

Hilabete bat baino gutxiago

Bat eta lau hilabete artean

Bost eta zortzi hilabete artean

Bederatzi eta hamar hilabete artean

Urte bat baino gehiago

Después de la sección 2 ir a la sección 4 (Maskaren ordezkapena)

Sección 3 de 4

Erantzuna ezezkoa bada

Azajepena (aukeraketa)

Zure lantokian erabili al dute maskara mota hori? *

Bai

Ez

Después de la sección 3 ir a la sección 3 (Erantzuna ezezkoa bada)

Sección 4 de 4

Maskaren ordezkapena


Azajepena (aukeraketa)

Zure lantokian aldatu al dituzte dagueneko maskara-mota horiek? *

Bai

Ez


SME-ren INKESTA SENDAGILEEI
GRAFENODUN MOSUKOEN ERABILERARI BURUZ



EMAITZAK

ESI BAKOITZEKO GALDETUAK


Lagina: 116 sendagile

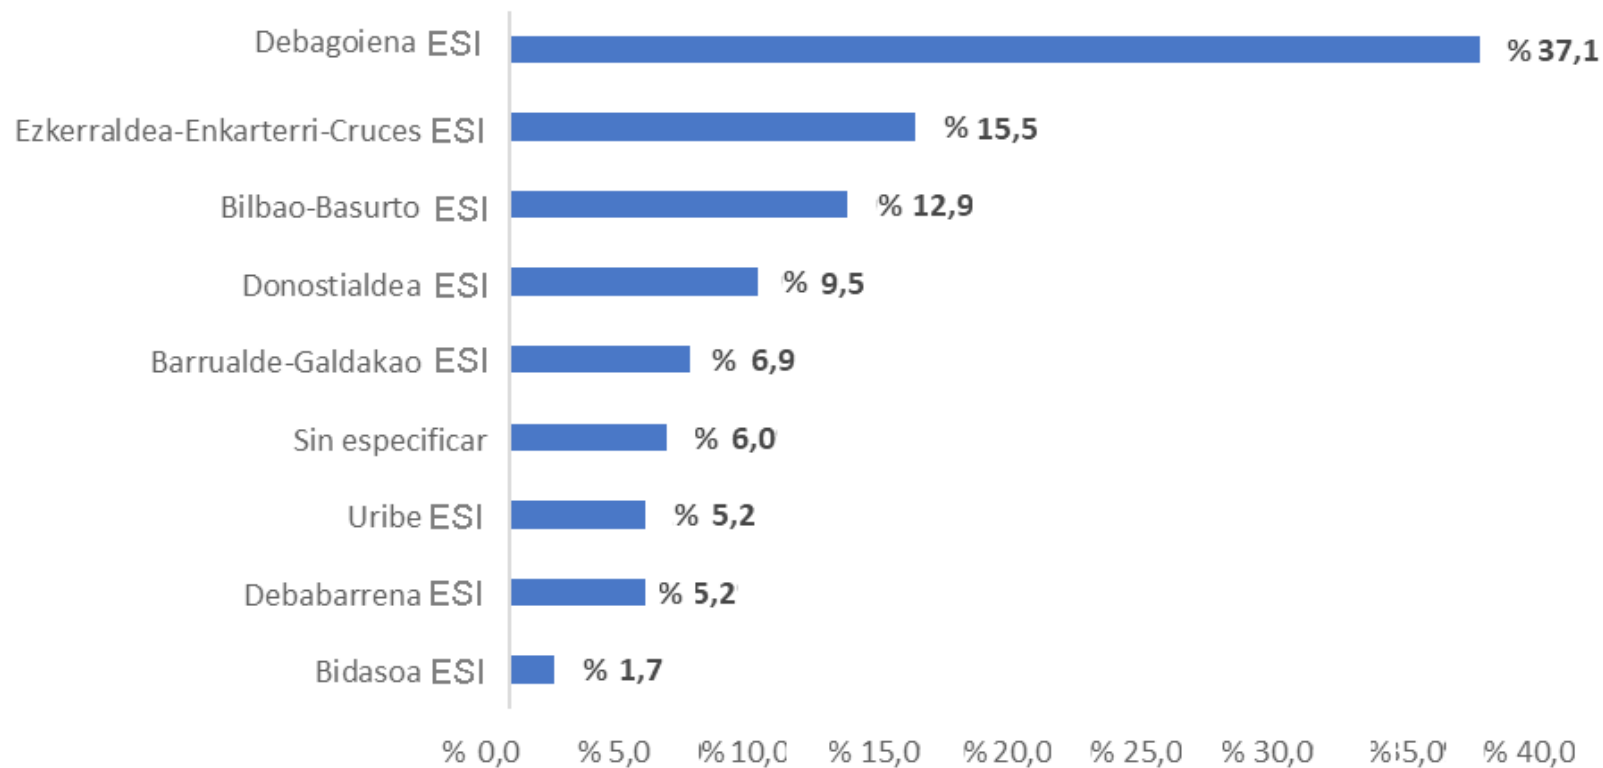

EMAITZAK

Erabili al duzu lanean mosuko mota hori?


Lagina: 116 sendagile

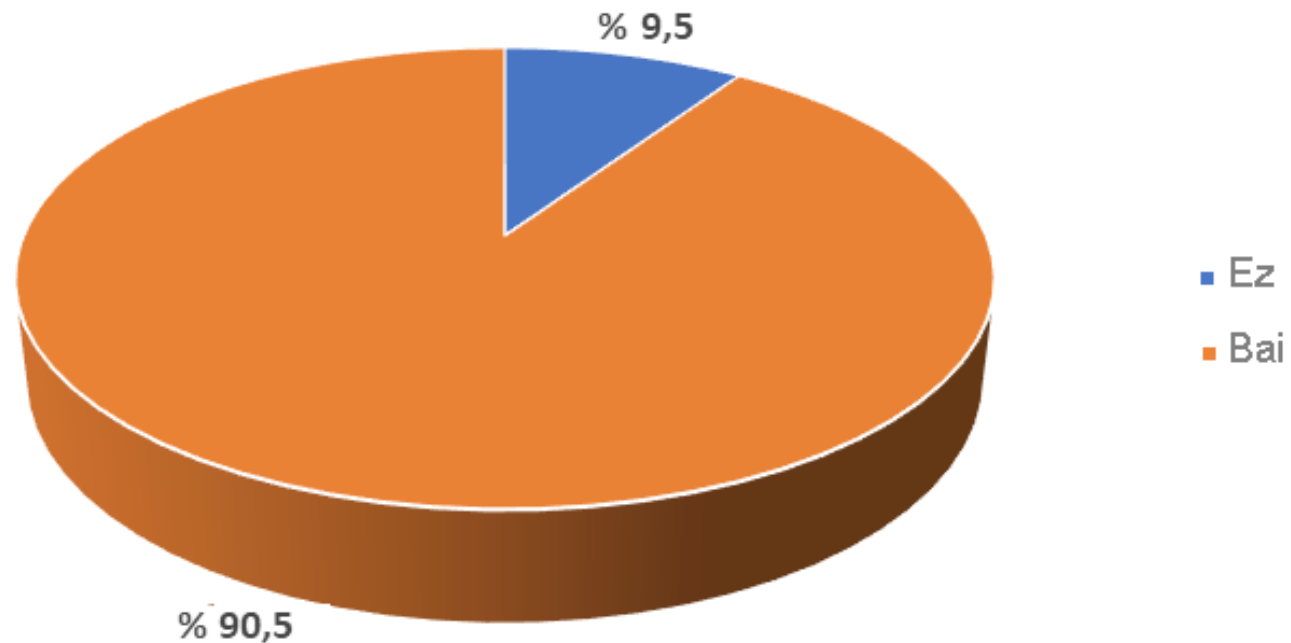

EMAITZAK

Zenbat denbora eman duzu mosuko hori jantzita?


Lagina: mosuko hori erabili duten 105 sendagile

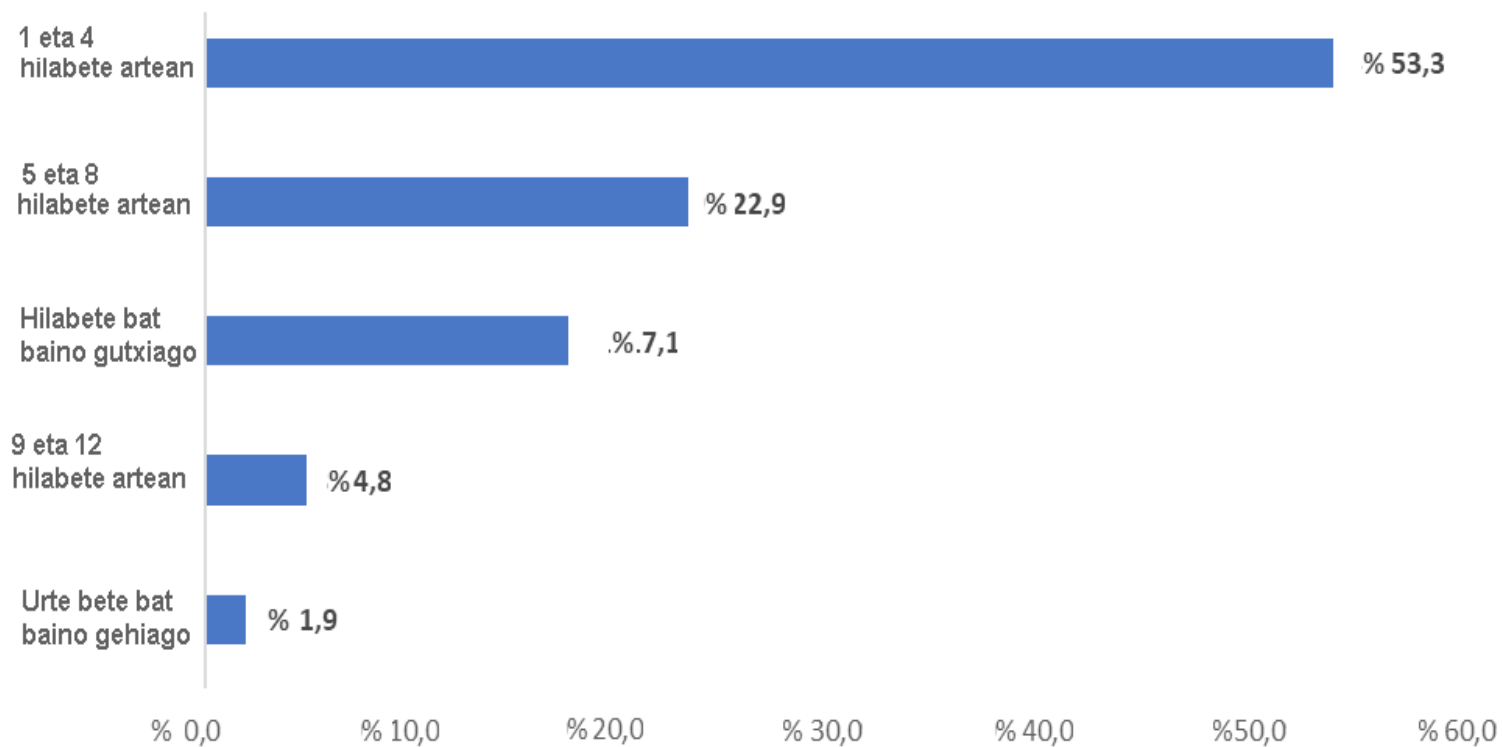

EMAITZAK

Zure lantokian erabili al dute mosuko mota hori?


Lagina: mosuko mota hori erabili ez duten 11 sendagile

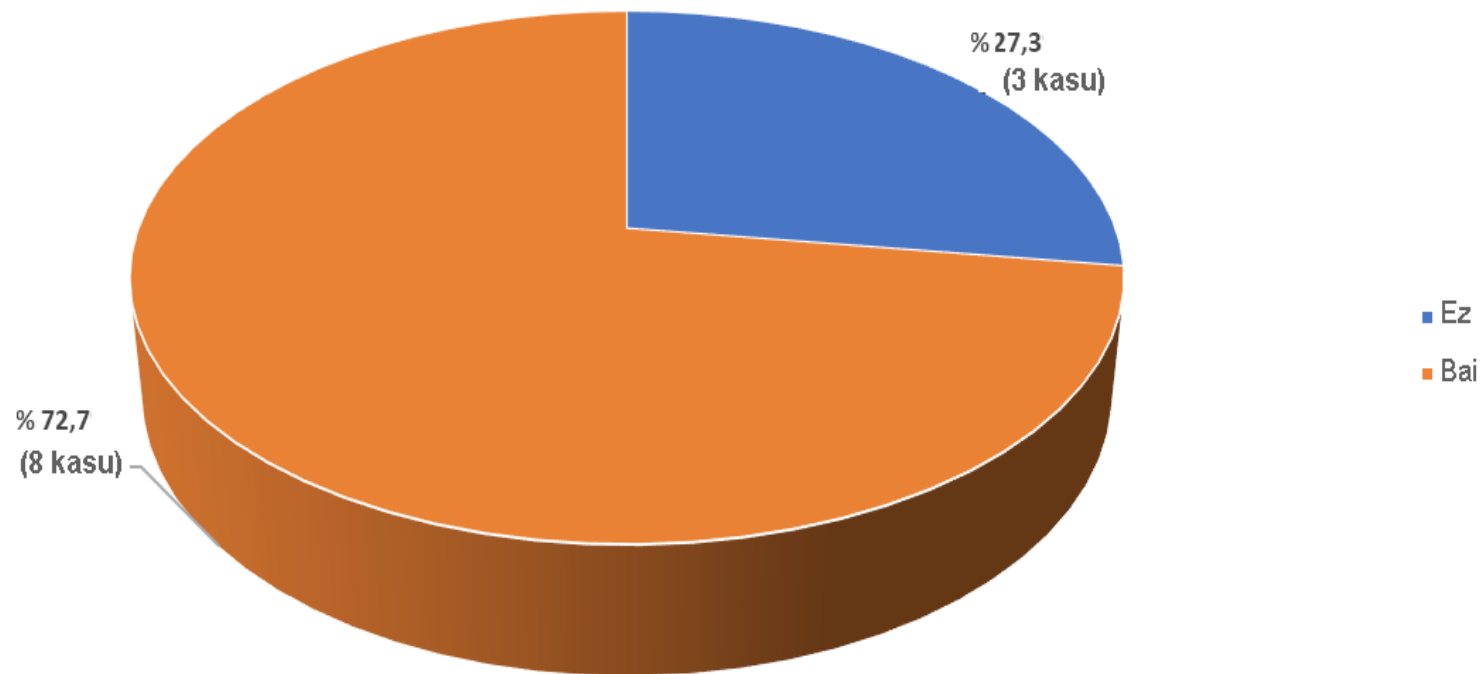

EMAITZAK

Zure lantokian ordezkatu al dituzte dagoeneko
mosuko mota horiek?

Lagina: mosuko mota hori erabili duten edo euren lantokian ikusi duten
113 sendagile

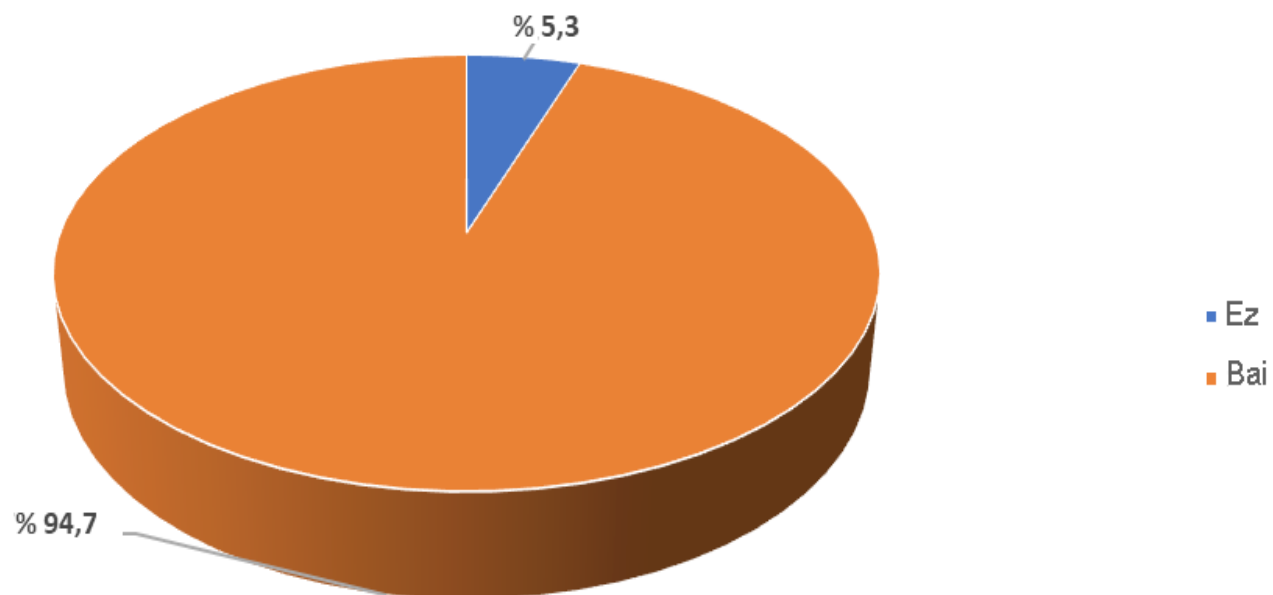

ESKERRIK ASKO GUZTIOI INKESTA HONETAN PARTE HARTZEAGATIK

SME-REN INKESTA SENDAGILEEI GRAFENODUN MOSUKOEI BURUZ

